
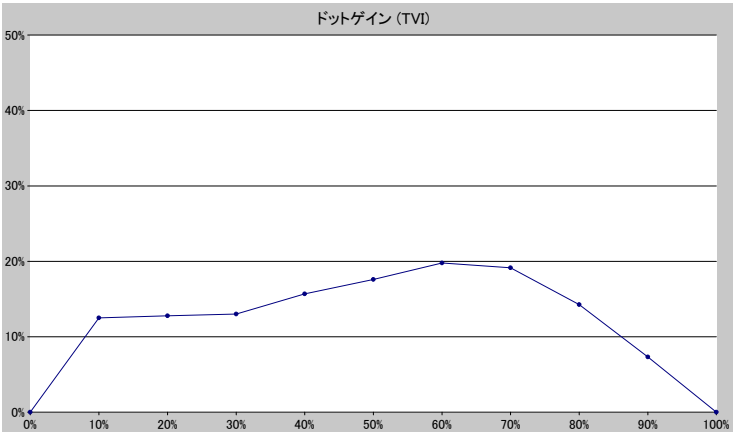


スポットカラーの定義

NP1785-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0549	0.0056
390	0.0814	0.0049
400	0.1250	0.0057
410	0.1539	0.0059
420	0.1636	0.0057
430	0.1643	0.0057
440	0.1625	0.0059
450	0.1549	0.0057
460	0.1371	0.0055
470	0.1138	0.0053
480	0.0937	0.0053
490	0.0758	0.0051
500	0.0592	0.0049
510	0.0502	0.0047
520	0.0479	0.0046
530	0.0434	0.0046
540	0.0385	0.0045
550	0.0443	0.0045
560	0.0894	0.0049
570	0.2000	0.0059
580	0.3576	0.0070
590	0.5558	0.0082
600	0.7185	0.0090
610	0.7951	0.0097
620	0.8252	0.0100
630	0.8386	0.0104
640	0.8487	0.0108
650	0.8548	0.0112
660	0.8541	0.0118
670	0.8479	0.0122
680	0.8493	0.0125
690	0.8607	0.0128
700	0.8734	0.0131
710	0.8795	0.0138
720	0.8815	0.0143
730	0.8844	0.0150

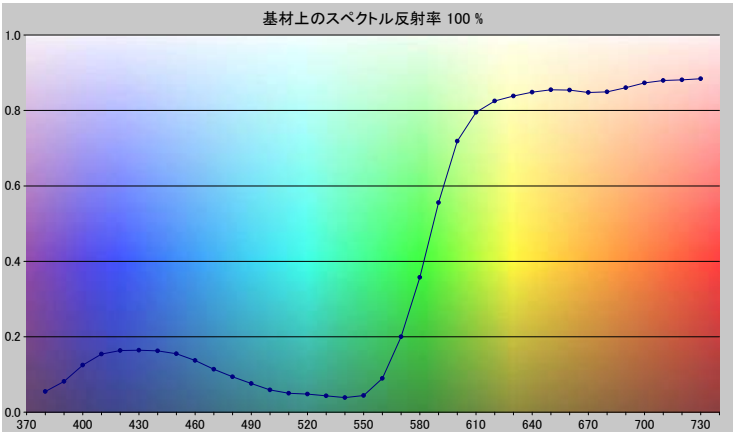



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.15	-0.15	0.21	225.66	0%
10	88.69	10.02	-0.33	10.03	358.11	22%
20	86.37	15.19	0.04	15.19	0.16	33%
30	83.89	20.86	0.79	20.88	2.18	43%
40	80.35	28.29	2.21	28.38	4.47	56%
50	76.62	36.38	4.59	36.66	7.20	68%
60	72.16	45.71	8.18	46.44	10.14	80%
70	67.83	54.16	13.26	55.76	13.76	89%
80	64.66	59.76	18.50	62.56	17.20	94%
90	62.31	63.44	22.93	67.46	19.87	97%
100	59.79	67.16	28.69	73.03	23.13	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	18%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

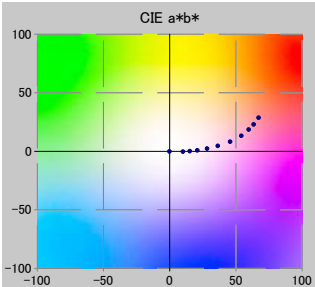

NP1785-U	
----------	--

ブランドカラー	NP1785-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00